

The MAX HAND

MARS III Auxiliary Extension.

Electrodos Ergonómicos para Manos, de escritorio para Mars III y para Unidad Qbit del programa SuperTuning.

Número De Orden de BCL: Z-07296

www.copen.com.mx


Instruction Manual

Manual De Instrucción



© 2004 – 2008 Bruce Copen Laboratories

The MAX HAND - Electrodo Ergonómico de Manos, de escritorio para Mars III y para la Unidad de enlace Qbit para el SuperTuning.

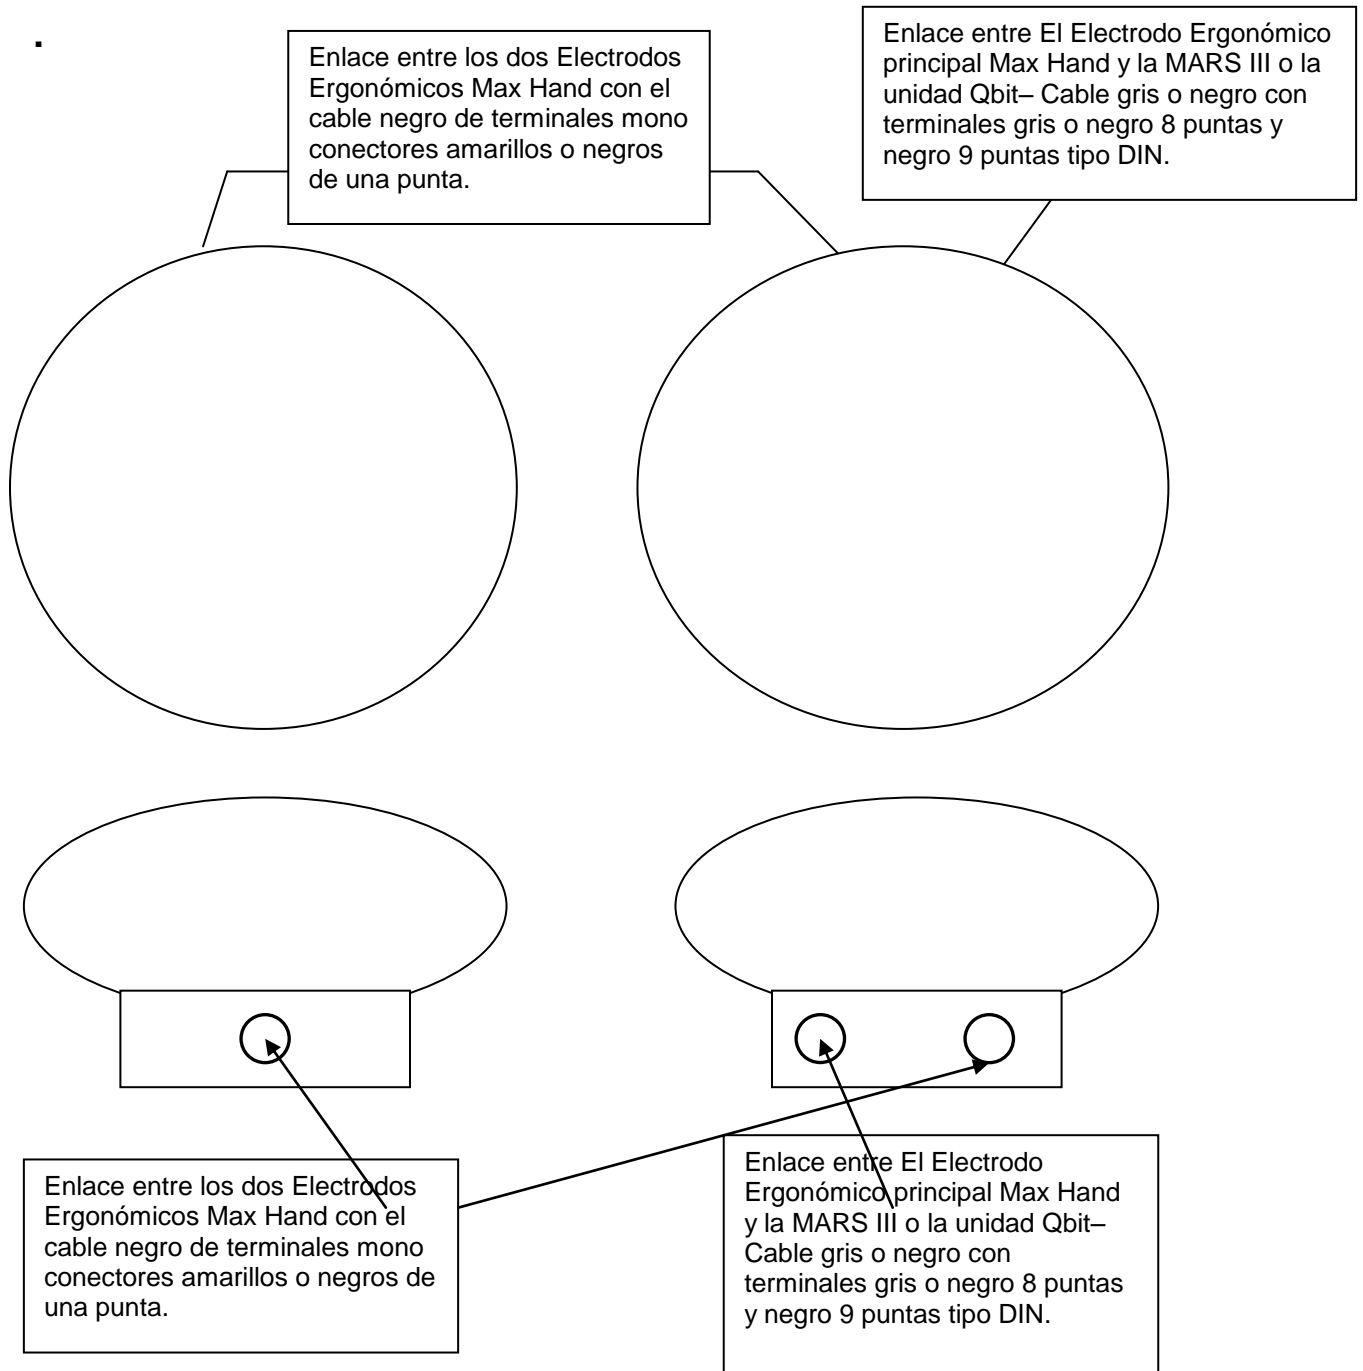

¡¡¡ATENCIÓN!!! AL SENTIDO Y A LA ORIENTACION DE LAS FICHAS DE CONEXIÓN. UNA MALA POSICIÓN PUEDE DAÑAR LAS PUNTAS DE LOS CONECTORES DIN MULTIPUNTAS E IMPEDIR LA CORRECTA CONEXIÓN O CAUSAR DAÑOS A LOS APARATOS. NUNCA FUERCE LA ENTRADA. SI LA ORIENTACIÓN ES CORRECTA, LAS FICHAS ENTRAN SUAVEMENTE.

Introducción

Gracias por elegir un accesorio que se utilizará con nuestros sistemas de Biocomunicación por Resonancia MARS III y, o el programa SuperTuning con la Unidad de enlace Qbit y la Lámpara ColorLab producidos por los laboratorios Ltd de Bruce Copen, Alemania.

La compañía produce los instrumentos y los dispositivos de Radiónica para Homeopatía electrónica por más de 60 años.

Diseñado específicamente para el uso con el sistema Copen MARS III (Sistema de Resonancia Analítico Múltiple y Biocomunicación), y, o con el programa SuperTuning con la Unidad de enlace Qbit y la Lámpara ColorLab estos electrodos son extremadamente precisos y cómodos.

Nota: Según el año de compra anterior a 2008, su modelo de Mars III puede tener conexiones diferentes a las descritas aquí. Envíenos el número de su unidad en el caso de desear diferentes accesorios.

Composición del envío

Compruebe por favor inmediatamente al recibir su pedido si la entrega es completa;

1 unidad MÁX HAND – **Electrodos Ergonómicos para Manos, de escritorio para Mars III y Qbit** con la etiqueta de la compañía y dos enchufes conectores en la parte posterior.

1 unidad MÁX HAND, con un enchufe conector en la parte posterior.

1 cable gris o negro que conecta los Electrodo MAX HAND al sistema MARS III o la unidad Qbit en la salida AUX2. Conexiones tipo DIN multipunta. Conector 9 puntas y conector 8 puntas

1 cable negro con terminales amarillos o negro de una punta que conecta los dos electrodos entre ellos.

Descripción

Los MAX HAND consisten en dos Electrodo Ergonómicos de escritorio que se han creados para colocar las manos del paciente de manera más cómoda que en el anterior sistema de los electrodos tradicionales.

Los Electrodo MAX HAND junto con el Sistema MARS III o la unidad Qbit del SuperTuning y la lámpara ColoLab le ofrece las ventajas siguientes:

1 La capacidad de analizar, escanear un paciente sin requerir de una muestra de pelo ni de sangre.

2 Le permite transmitir directamente al paciente cualquier información mediante el contacto con los electrodos MAX HAND

Conectar los MAX HAND con el sistema MARS III o el Qbit: cuidado. Respete la orientación y nunca fuerce la entrada!!!

Lea por favor las instrucciones siguientes cuidadosamente antes de usar los accesorios.

El Electrodo, aplicador para Mano MAX HAND Principal se debe conectar con el conector enchufe de su sistema MARS III a la entrada AUX 1 u 2 u 3 en la parte posterior de la unidad de MARS III o de la unidad Qbit usando el cable gris o negro con conector de 9 puntas tipo DIN. **ATENCIÓN DE NO FORZAR, si la orientación es respetada, la conexión se realiza suavemente.**

El otro extremo de este cable gris o negro con un conector 8 de puntas tipo DIN se conectará al electrodo principal (el que lleva dos conexiones)

El cable negro con dos mono conectores amarillos o negros de una punta se utiliza para conectar las dos unidades MÁX HAND juntas como demostrado arriba.

Guía Operacional

Por favor note que los electrodos no han de ser agarrados con fuerza, las manos del paciente solo han de posarse sobre ellos haciendo un buen contacto.

Para tratamientos en la clínica, asegúrese de que su paciente esté cómodamente instalado y relajado.

Limpieza y Mantenimiento

Limpie los electrodos MAX HAND con regularidad con un paño húmedo o use alcohol (45 vol. %). **Nunca moje totalmente las unidades MAX HAND ni las sumerja en líquidos.**

Servicio técnico

Las unidades en principio no necesitan mantenimiento técnico excepto su limpieza externa. Le recomendamos inspeccionar los electrodos con regularidad así como sus conexiones. No intente nunca abrirlos, ni reparar un desperfecto por su cuenta. Envíe las unidades dañadas a nuestro servicio técnico Bruce Copen Laboratories. **NO ABRA NUNCA LOS ELECTRODOS MAX HAND**, podrían ser irreparables o causarle algún perjuicio.

¿Preguntas?

Si tuviera alguna pregunta con respecto a este o algunos otros accesorios de Copen, llame a su distribuidor local o a la central en Alemania por favor, escribanos o envíenlas por telefax o E-Mail. Numere por favor sus preguntas, así nos será más fácil referirnos a cada una de ellas.



Web: www.copen.de
e-mail: info@copen.de
Production: Bruce Copen Laboratories,
Hainbuchenring 4
82061 Neuried
Germany
Tel: 0049 - (0)89 – 201 806 120 Fax: 0049 - (0)89 – 201 806 125

© 2004 – 2008 by Bruce Copen Laboratories . All rights reserved. No part of this document can be reproduced in any form whatsoever - photocopy, microfilm, or by any other process - or translated into a language that can be used by machines, especially data processing machines, without the written consent of Bruce Copen Laboratories Ltd.

Orgone Tecnología SA de CV
Distribuidor exclusivo autorizado para México y Centroamérica

www.copen.com.mx